

議 事 要 旨

区 分	摘 要
日 時	令和4年7月20日(水) 18:00 ~ 18:20
会 議 名	令和4年度 第2回手術部連絡協議会
場 所	日亜ホール White(小)
出 席 者	別紙のとおり
欠 席 者	別紙のとおり
陪 席	別紙のとおり

議 事

議題・報告

1. 安全対策：感染対策関連

①新型コロナウイルス感染症高リスク手術の制限緩和について

富山副部長から、新型コロナウイルス感染症高リスク手術の制限緩和について説明があった。新型コロナウイルス感染症高リスク手術を行う際には、陰圧室で手術を行ってきたが、他大学の多くでは陰圧室を使用していないこと、学会等で陰圧室使用に関する基準を設けていないこと等の状況を踏まえ、感染制御部と協議を行った結果、現状より制限を緩和することとなった。

②新型コロナウイルス感染症手術シミュレーションについて

富山副部長から、新型コロナウイルス感染症手術シミュレーションについて説明があった。コロナウイルス感染拡大の第7波を受け、改めてシミュレーションを行う。産婦人科の帝王切開を想定。

2. 手術部機器管理

①移動型透視用 X 線装置（外科用イメージ）の故障について

富山副部長から、移動型透視用 X 線装置（外科用イメージ）の故障について説明があった。当該装置を 3 台で運用していたが、このうちの 1 台が故障したため、これの代わりにフィリップス Zenition70 を購入予定。納期が 4 カ月程度かかるため、その間は代替機を借りて対応する。

②手術部内の機器保管場所の不足に伴う、手術機器の廃棄・移動の検討について

富山副部長から、手術部内の機器保管場所の不足に伴う、手術機器の廃棄・移動の検討について説明があった。以前より手術部内の機器保管場所の不足に伴う、手術機器の廃棄・移動の検討についてアナウンスを行っているが、昨年度末多くの機器が購入・設置されたことに伴い、さらに強力にこれを進める必要があり、各診療科へ個別に相談をさせていただく予定である。その際には是非ご協力いただきたい。

3. 設備管理

①学生用手術着購入について

富山副部長から、学生用手術着購入について報告があった。青藍会より学生用手術着を寄贈いただける旨申し出があり、100 着の学生用手術着を購入することとなった。不足するようであれば追加で購入する。

4. 手術部運営

①稼働状況について

富山副部長から、稼働状況について説明があった。昨年度と比較して、5月は61件、6月は45件手術件数が増えており、ついては調整にご協力いただきたい。また、申し込みの際、手術予定時間はなるべく実態に合わせて申込みいただきたい。

2022年度 手術部連絡協議会名簿

R4.7.20

※徳島大学病院手術部規則第 4条第2項に基づく

所 属	委員氏名 (関係副科長・副部長)	出席	代理者氏名	出席
手術部部長 *第1号	高木 康志			
関係診療科の副科長及び関係中央診療施設等の副部長 *第2号及び併合せ	循環器内科	若槻 哲三	川端 豊	
	血液内科	藤井 志朗	曾我部 公子	○
	心臓血管外科	北市 隆	藤本 鋭貴	
	食道乳腺甲状腺外科	井上 聖也	河北 直也	○
	呼吸器外科	鳥羽 博明	河北 直也	○
	泌尿器科	高橋 正幸	楠原 義人	○
	消化器・移植外科	森根 裕二	齋藤 裕	
	小児外科・小児内視鏡外科	森 大樹	齋藤 裕	
	眼科	四宮 加容	江川 麻理子	○
	耳鼻咽喉科・頭頸部外科	佐藤 豪	東 貴弘	○
	整形外科	浜田 大輔	和田 佳三	
	皮膚科	村尾 和俊	仁木 真理子	
	形成外科・美容外科	安倍 吉郎	峯田 一秀	
	脳神経外科	兼松 康久	藤原 敏孝	
	麻酔科	角田 奈美	笠井 飛鳥	○
	精神科神経科・心身症科	中瀧 理仁	富岡 有紀子	○
	小児科	渡辺 浩良		
	産科婦人科	西村 正人	香川 智洋	
	歯科口腔外科 (口腔内科)	桃田 幸弘		
	歯科口腔外科 (口腔外科)	栗尾 奈愛	高丸 菜都美	
	歯科口腔外科 (歯科麻酔科)	高石 和美	西川 美佳	○
	*手術部	富山 芳信		
	放射線部 *医科	音見 暢一	榎本 英明	
	放射線部 *歯科	細木 秀彦	水頭 英樹	
	救急集中治療部	板垣 大雅	上野 義豊	
	輸血・細胞治療部	三木 浩和		
	安全管理部	大坂 朱美	藤本 理恵子	
	感染制御部	高橋 真理		
	物流センター	近藤 武		
副看護部長 *第3号	横田 三樹	○		
手術部看護師長 *第4号	秋山 幸子	○	池添 照代	
物流センター副看護師長 *第4号	(兼任 横田 三樹)	○		
手術部副看護師長 *第5号	池添 照代		秋山 幸子	○
医事課 副課長 *第6号	松井 徹	○	藤原 慶一	
ME管理センター臨床工学技士 *第7号	藤井 有美子			

陪席

予算管理係 係長

経営企画係 係員

医療支援係 係長

医療支援係 係員

斉藤 憲市

多田 ちひろ

藤原 慶一

大西 貴士

2022 年 7 月 手術部連絡協議会議題

1. 安全対策；感染対策関連

- ①新型コロナウイルス感染症高リスク手術の制限緩和について：資料 1
- ②新型コロナウイルス感染症手術シミュレーションについて

2. 手術部機器管理：

- ①移動型透視用 X 線装置（外科用イメージ）の故障について：資料 2
- ②手術部内の機器保管場所の不足に伴う、手術機器の廃棄・移動の検討について

3. 設備管理：

- ①学生用手術着購入について：資料 3

4. 手術部運営：

- ①稼働状況について：資料は別途送付済み

新型コロナウイルス感染症高リスク手術の制限緩和について


手術部 2022.6.28

- ①新型コロナウイルス感染症患者では、気道系の手術、特に耳鼻咽喉科の鼻・副鼻腔手術、気管切開、脳神経外科のハーディ手術などを行う際に、ウィルスの混じったエアロゾルが大量に発生するとされ、それらの手術は感染の**高リスク手術**とされています。
- ②それらの手術では感染の拡散を防ぐため、現在**陰圧室**(OR2、OR13)を使用しています。(他の部屋は陽圧)
- ③当該手術実施後は、片付け・清掃を開始する前に**エアロゾル処置**のため、**全員退室**の後、一定時間**扉を締切り**静置していました(1時間)(**静置時間**)。静置時間等については、2022.5.13に15分に**短縮**していたところです。
- ④他大学の多くで**陰圧室の使用がなされていないこと**、各学会等で**陰圧室使用に関する基準もないこと**から感染制御部と協議を行い、下記のように追加の制限緩和をすることになりました。


――記――

- 1. 術前48時間以内に抗原定量検査等で**陰性が確認されていれば、陰圧室以外の手術室でも実施可**とします。ただし、耳鼻咽喉科の月曜手術の場合は、前週金曜日に陰性が確認されてい入れば可とします。**急患で迅速キット(抗原定性検査)のみ**の場合は**陰圧室を優先**して使用します。ただし、緊急度によってはその限りではありません。
- 2. 静置時間は置きません。ただし、昨年度末に導入した紫外線照射装置 LIGHT STRIKE による環境表面のウィルス除去は継続します。**10分程度**必要です。
- 3. **患者入れ替え時間**は**静置時間(紫外線照射時間を含む)に片付け・清掃と部屋準備の時間(およそ20分)**を足したものになりますので、前回の緩和後**40分程度**であったものが、**30分程度**となります
- 4. マスクについても、陰性が確認されていれば、N95マスクは使用せず通常のサージカルマスクも可とします。ゴーグル等は従来通り。

従来

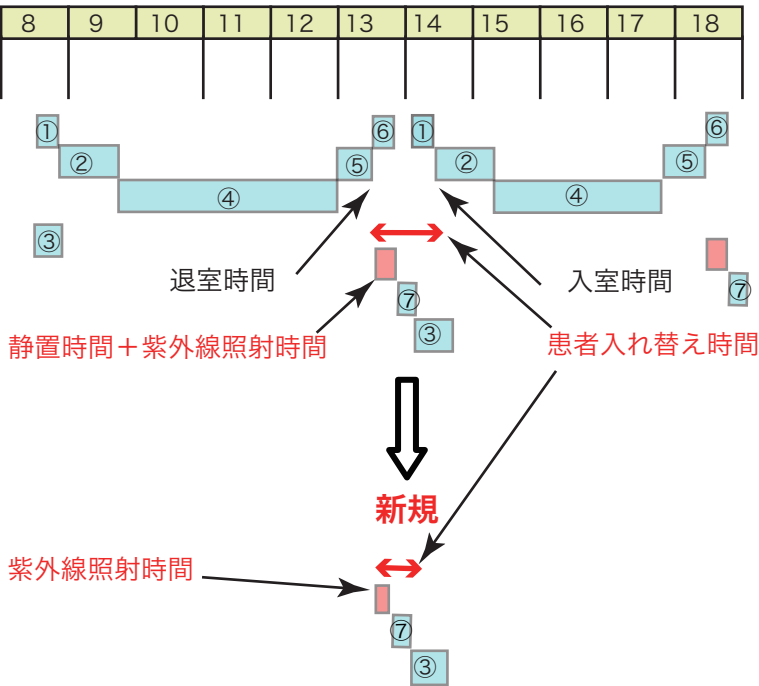

- ①麻酔器、薬の準備、②ライン・硬膜外カテ挿入、麻酔導入、体位、手洗、消毒
- ③手術機器・器材の準備④手術、⑤麻酔覚醒、⑥麻薬・毒薬の処理、
- ⑦手術機器・器材の片付け、手術室の清掃

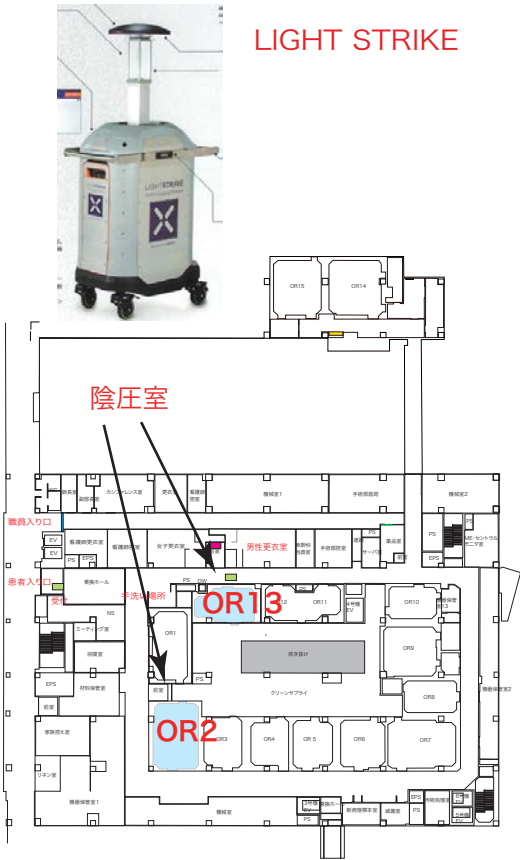

移動型透視用X線装置(外科用イメージ)の故障について

現状

通常型の移動型透視用X線装置(外科用イメージ)
3台 2011, 2010, 2020
足りないことがある 週1例程度←調整が必要

Ziehm VisionFD Vario3D 故障

⇒フィリップZenition 70
パネル 径 21cm X 21cm を購入予定

現有の フィリップZenition 70
パネル 径 26cm X 26cm
より、パネルが小さくなる

納期が4ヶ月ほどかかる見込み。その間、代替機が手配できる見込み

- Oアーム (2018)
- 蘭国フィリップ ステ イカルシステム 製 BV Pulsera 9 (2011)
- Ziehm Imaging FD vario 3D (2010)
- フィリップス 3D Zenition 70 (2020)
- 画像処理診断装置他 (2010)
- ポータブル撮影装置 (2013)
- ハイブリッド手術装置 (2015)
- X線防護具



学生用手術着購入

- ①枚数については、まずは100着(男女50着ずつ)購入、
必要数を配置、適宜 追加購入を依頼する。

スクラブ	女性	S 20、M 20
	男性	L 45、LL 15
パンツ	女性	M 20、L 20
	男性	M 25、L 25、LL 10


- ②保管場所については、かごを購入し、男女更衣室の手術衣の
棚の上に定数を決め保管する。予備の手術衣は別の場所に保管
する。
③手術着の色は(男性用 女性用 ともネイビー)、
④手術着のサイズは①に記載、SからLLまで、



ロゴ

場所は左胸

大きさは幅10cm程度 高さは2+α cm



履物ロッカー	ロッカー
4×6×1=24(上下2段)	1段3分割
3×6×1=18(上下2段)	2段3分割
4×10=40(1段)	1段4分割

